



Szpital Powiatowy w Sochaczewie

Nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.27.D.2019

Sochaczew, dnia 24.06.2019r

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 38 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r w nawiązaniu do SIWZ, nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.27.D.2019, dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę obłożenia pola operacyjnego dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie odpowiadamy na pytania Wykonawców:

Pytanie 1: Zadanie II, poz.1. Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne 3-warstwowe? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 2: Zadanie II poz. 2. Czy Zamawiający dopuści umieszczone na półmasce znakowanie wyłącznie typu maski?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 3: Zadanie II poz.2. Czy Zamawiający dopuści: nazwę, znak handlowy-identyfikator producenta; znakowanie identyfikujące typ wyrobu; numer i rok produkcji na opakowaniu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 4: Zadanie I, pozycja 1-2. Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 5: Zadanie I, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści czepek nieposiadający przedniej części wydłużonej, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 6: Zadanie II, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści maski 3 warstwowe?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 7: Zadanie II, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści maski wyposażoną w osłonę na oczy odporna na zaparowanie?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 8: Zadanie IV, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 9: Zadanie IV, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści spodenki do badań z rozcięciem bez zakładki?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 10: Zadanie IV, pozycja 2, 3, 6. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

96-500 Sochaczew; ul. Batalionów Chłopskich 3/7

KRS 0000020330; NIP 837-15-07-803; REGON 017222233

www.szpitalsochaczew.pl

Tel. 46 86-49-521, fax 46 86-49-525, e-mail: dor@szpitalsochaczew.pl



Pytanie 11: Zadanie IV, pozycja 7. Czy Zamawiający dopuści podkład perforowany co 37,5cm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 12: Zadanie V, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym mankietem?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 13: Zadanie V, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 14: Zadanie VI. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety o wymiarach 45cm x 60cm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 15: Zadanie VII. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na kończynę o wymiarach 30cm x 80cm o gramaturze 56 g/m².

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 16: Zadanie VIII Czy Zamawiający dopuści prześcieradło chłonne o parametrach:

- 5 warstwy: włókniny polipropylenowej, warstwy celulozowej, pulpy celulozowej z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej, niebieskiej folii PE
- Wkład chłonny pikowany (wata, superabsorbent SAP, pulpa)
- Rozmiar: 100 cm x 225 cm, wkład chłonny; 50 x 205 cm, marginesy wzdłuż krótszego brzegu: 10cm, wzdłuż dłuższego brzegu 25cm
- Chłonność 3820,18 ml.
- Jednorazowego użytku
- Niejałowy

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 17: Zadanie XXII. Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 18: Zadanie XXII. Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMMMS ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 19: Zadanie XXII. Czy Zamawiający dopuści fartuch o następujących długościach M - 124cm, L - 128cm, XL - 138cm, XXL - 157cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 20: Zadanie XXIII. Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 21: Zadanie XXIII. Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienie o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 22: Zadanie XXIII. Czy Zamawiający dopuści fartuch o następujących długościach M - 124cm, długość rękawa 60cm, L - 128cm długość rękawa 61cm, XL - 138cm długość rękawa 61cm, XXL - 157cm długość rękawa 61cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 23: Zadanie XXIII. Czy Zamawiający dopuści fartuch na o odporności na przenikanie cieczy 66 cm H₂O, BI=3.2.?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 24: Pytanie do parametrów do oceny jakościowej - obłożeń pola operacyjnego. Uprzejmie prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zestawów pakowanych w karton w formie podajnika jako kryterium oceny jakościowej.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 25: Pytanie do parametrów do oceny jakościowej - fartuchy operacyjne. Uprzejmie prosimy

Zamawiającego o odstąpienie od wymogu fartuchów chirurgicznych z zapięciem przy szyi, pozwalającym na wybór miejsca zapięcia jako kryterium oceny jakościowej.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 26: zadanie IX-XXI. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznego pakowania zestawów w postaci podwójnego zabezpieczenia: foliowy worek i karton.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27: zadanie IX-X. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu wewnętrznego włókninowego owinięcia zestawów i pojedynczych akcesoriów/serwet w zadaniu X.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 28: zadanie XI-XXIII. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu wewnętrznego włókninowego owinięcia zestawów.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 29: zadanie IX. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z minimalnymi różnicami w wymiarach:

- a) serweta operacyjna w rozmiarze 180cm x 180cm zamiast 175cm x 200cm
- b) serweta na stolik instrumentariuszki 150cm x 190cm zamiast 140cm x 190cm
- c) ręczniki 30.5cm x 34cm zamiast 30cm x 30cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 30: zadanie IX. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z minimalnymi różnicami w wymiarach:

- a) serweta operacyjna w rozmiarze 150cm x 180cm zamiast 175cm x 200cm
- b) serweta operacyjna w rozmiarze 150cm x 230cm zamiast 150cm x 240cm
- c) serweta na stolik instrumentariuszki 150cm x 190cm zamiast 140cm x 190cm
- d) ręczniki 30.5cm x 34cm zamiast 30cm x 30cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę

Pytanie 31: zadanie X poz.2 . Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety w rozmiarze 150cm x 210cm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 32: zadanie X poz.3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ręczników pakowanych pojedynczo z odpowiednim przeliczeniem ilościowym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 33: zadanie X poz.4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na stolik Mayo w rozmiarze 80cm x 140cm o gramaturze 80 g/m².

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 34: zadanie X poz.5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kieszeni w rozmiarze 30cm x 40cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 35: zadanie X poz.7. Prosimy o dopuszczenie serwety dwuwarstwowej o gramaturze 40g/m², spełniającej wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013. Obłożenia chirurgiczne i/lub wyroby medyczne, stosowane są m.in. w celu zapewnienia czystej mikrobiologicznej strefy roboczej wokół rany oraz w celu zmniejszenia przenoszenia flory bakteryjnej skóry pacjenta do rany. Wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013 w tym: odporność na przenikanie drobnoustrojów oraz odporność na penetrację cieczy na poziomie >100 cm H₂O, zapewniają wysokie bezpieczeństwo oraz ochronę pacjenta, jak również wpływają na zminimalizowanie zakażeń i infekcji. Chcemy nadmienić, że serwety dwuwarstwowe o gramaturze 40 g/m² wykonane są z wysokochłonnego polipropylenu typu spunlace oraz nieprzemakalnej folii polietylenowej, co także wpływa na barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla pacjenta. Nadrzędnym celem produkcji wyrobów medycznych jest wytwarzanie ich w taki sposób aby stosowanie ich nie zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu pacjentów. Ta dbałość została zachowana, gdyż mimo niższej gramatury serwety

dwuwarstwowe 40g charakteryzują się podwyższonym poziomem wymagań użytkowych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet dwuwarstwowych o gramaturze 40 g/m².

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 36: zadanie X poz.8. Prosimy o dopuszczenie serwety o rozmiarze 90cm x 120cm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 37: zadanie X poz.9. Prosimy o dopuszczenie serwety o rozmiarze 150cm x 210cm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 38: zadanie XI. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z minimalnymi różnicami w wymiarach:

- a) serweta operacyjna w rozmiarze 180cm x 180cm zamiast 175cm x 200cm
- b) serweta na stolik instrumentariuszki 150cm x 190cm zamiast 140cm x 190cm
- c) pady chłonne w serwetach o wymiarach 25cm x 60cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 39: zadanie XII. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z minimalnymi różnicami w wymiarach:

- a) serweta operacyjna w rozmiarze 180cm x 180cm zamiast 175cm x 200cm
- b) serweta na stolik instrumentariuszki 150cm x 190cm zamiast 140cm x 190cm
- c) pady chłonne w serwetach o wymiarach 25cm x 60cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 40: zadanie XI-XIII,XVII. Prosimy o dopuszczenie parametru odporności na przenikanie cieczy 200±3 cm H₂O.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 41: zadanie XIII. Prosimy o dopuszczenie zestawu o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm, wzmocnienie 75cm x 140cm
- 1 x serweta samoprzylepna 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna 180 cm x 180 cm
- 2 x serweta samoprzylepna 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny 30.5 cm x 34 cm
- 3 x taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę 30 cm x 120 cm
- 1 x bandaż elastyczny 10cm x 450cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu 150 cm x 190 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 42: zadanie XVII. Prosimy o dopuszczenie zestawu o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230cm x 300cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm (wzmocnienie 100 cm x 50 cm)
- 4 x ręcznik chłonny
- 3 x taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę 22 cm x 75 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona 150 cm x 190 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu 150 cm x 190 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 43: zadanie XVIII,XIX. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zestawu, gdzie serweta główna wykonana jest z hydrofobowej włókniny typu SMS o odporności na przenikanie cieczy 41 cm H₂O. Dodatkowo w strefie krytycznej serweta posiada wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m² zwiększające odporność na przenikanie cieczy do 110 cm H₂O. Materiał SMS charakteryzuje się dużą wytrzymałością i właściwościami odpychającymi płyny co zapewnia należyte bezpieczeństwo i ochronę

w obrębie pola operacyjnego.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 44: zadanie XVIII. Prosimy o dopuszczenie zestawu o składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm oraz torbą do zbiórki płynów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie o gramaturze 80 g/m²
- 1 x serweta bez przylepca 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik włókninowy 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu 150 cm x 190 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 45: zadanie XIX. Prosimy o dopuszczenie zestawu o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm z portami do podłączenia drenów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka 75 cm x 80 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu 150 cm x 190 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 46: Dotyczy zadania IX. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu dostarczanego na podstawie obecnej umowy przetargowej? Różnica względem opisanego zestawu w wymiarach elementów poniżej:

- 1 serweta na stolik narzędziowy 150x190cm
- 1 serweta Mayo 78x145cm
- 1 serweta operacyjna 180x180cm
- 1 taśma 9x50cm
- 2 ręczniki 30,5x34cm
- Reszta zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 47: Dotyczy zadania X


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie:

- Poz. 2 – serweta 150x180cm
- Poz. 3 – ręczniki pakowane a 1 szt z przeliczeniem wymaganych ilości
- Poz. 4 – Mayo składane aseptycznie 78x145cm
- Poz. 5 – kieszeń dwukomorowa 30x40cm
- Poz. 6 – taśma 9x50cm
- Poz. 7 – serweta 50x75cm
- Poz. 8 – serweta 150x240cm
- Reszta zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 48: Dotyczy zadania XI. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wzmocnionego:

- 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm),
- 4 ręczniki do rąk 30,5x34cm
- 2 przyklejane serwety 2-warstwowe na całą powierzchnię z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50 cm
- 1 przyklejana serweta średnia (2-warstwowa na całą powierzchnię) z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm
- 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (2-warstwowa na całą powierzchnię)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

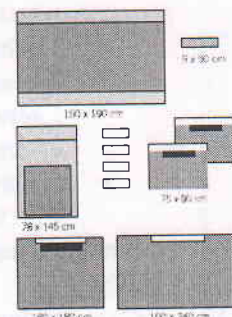

Gramatura serwet 2 warstwowych 60g/m² + łata chłonna 80g/m². Odporność na penetrację płynów 165cm H₂O.


Reszta zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 49: Dotyczy zadania XII Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego z poniższych zestawów wzmocnionych:

ZESTAW A

- 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm),
- 4 ręczniki do rąk 30,5x34cm
- 2 przyklejane serwety 3-warstwowe na całej powierzchni z dodatkową łata chłonna 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50 cm
- 1 przyklejana serweta średnia (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x180cm) z dodatkową łata chłonna i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm
- 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x240cm)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

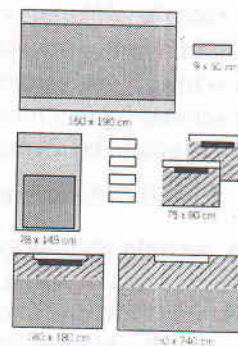


Gramatura serwet 3 warstwowych 75g/m² + łata chłonna 80g/m². Odporność na penetrację płynów 167cm H₂O.

Reszta zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

ZESTAW B

- 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm),
- 4 ręczniki do rąk 30,5x34cm
- 2 przyklejane serwety 3-warstwowe na całej powierzchni z dodatkową łata chłonna i organizatorami przewodów 75 x 90 cm, łata chłonna 25x60 cm
- 1 przyklejana serweta średnia (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x180cm) z dodatkową łata chłonna i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, łata chłonna 25x60 cm
- 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x240cm) z dodatkową łata chłonna 25x60 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

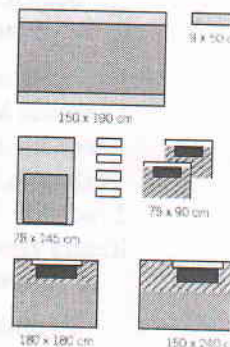

Gramatura serwet 3 warstwowych 75g/m² + łata chłonna 80g/m². Odporność na penetrację płynów 167cm H₂O.


Reszta zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 50: Dotyczy zadania XIII

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do chirurgii biodra:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 1 serweta 100 x 150cm 2-warstwowa na całej powierzchni
- 1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm (2-warstwowa na całej powierzchni) z warstwą chłonna 15 x 50 cm i organizatorami przewodów
- 1 osłona na nogę 36 x 120 cm
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta 230 x 260 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z wycięciem „U” 20 x 85 cm, z warstwą chłonna 50x100cm i organizatorami przewodów
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

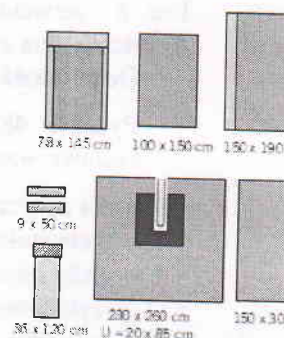

Gramatura serwet 2 warstwowych 60g/m² + łata chłonna 80g/m². Odporność na penetrację płynów 165cm H₂O.


Reszta zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 51: Dotyczy zadania XIV

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do żyłaków:

- 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm
 - 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm),
 - 4 ręczniki do rąk 30,5x34cm
 - 1 przylepna serweta 75 x 90 cm (3-warstwowa na całej powierzchni)
 - 1 serweta z wycięciem „U” 20 x 100 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta), z warstwą chłonną i organizatorami przewodów 230 x 260 cm, łata chłonna 75 x 140 cm
 - 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta 75x240cm), łata chłonna 25 x 60 cm
 - 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
- Gramatura serwet 3 warstwowych 75g/m² + łata chłonna 80g/m². Odporność na penetrację płynów 167cm H₂O.

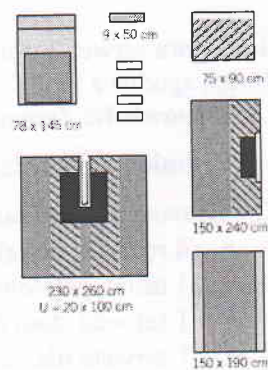

Reszta zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 52: Dotyczy zadania XVI

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do laparoskopii:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 4 ręczniki do rąk 30,5x34cm
- 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm
- 1 serweta laparoskopowa 230 x 300 cm, otwór 31 x 35 cm, warstwa chłonna 75 x 80 cm, organizatory przewodów
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Gramatura serwet 2 warstwowych 60g/m² + łata chłonna 80g/m². Odporność na penetrację płynów 165cm H₂O.

Reszta zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 53: Dotyczy zadania XVII

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów na kończynie:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 4 ręczniki do rąk 30,5x34cm
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium składana 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
- 1 elastyczna osłona na nogę 22 x 75 cm
- 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7cm, z warstwą chłonną 50 x 100 cm i organizatorami przewodów
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Gramatura serwet 3 warstwowych 75g/m² + łata chłonna 80g/m². Odporność na penetrację płynów 167cm H₂O.


Reszta zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 54: Dotyczy zadania XVIII

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu ginekologicznego:

- 3 ręczniki do rąk 30,5x34cm
- 1 serweta 75 x 120 cm (2-warstwowa na całej powierzchni)
- 2 legginsy (osłony na kończyny) 75 x 120 cm
- 1 serweta ginekologiczna dolna 140 x 150 cm (2-warstwowa na całej powierzchni)
- 1 serweta ginekologiczna górna 115 x 150 cm (2-warstwowa na całej powierzchni)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 100 x 150 cm

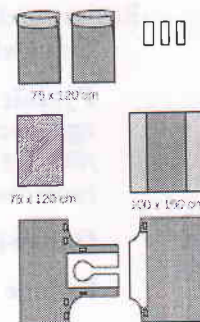

Gramatura serwet 2 warstwowych 60g/m². Odporność na penetrację płynów 165cm H₂O.
Reszta zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 55: Dotyczy zadania XIX

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cesarskiego cięcia:

- 4 ręczniki do rąk 30,5x34cm
- 1 taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm z torebką na płyny 72x72cm, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Gramatura serwet 2 warstwowych 60g/m². Odporność na penetrację płynów 165cm H₂O.
Reszta zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 56: Dotyczy zadania XX

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do barku:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 1 serweta 100 x 150cm 2-warstwowa na całej powierzchni
- 1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm (2-warstwowa na całej powierzchni) z warstwą chłonną 15 x 50 cm i organizatorami przewodów
- 1 osłona na nogę 36 x 120 cm
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta 230 x 260 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z wycięciem „U” 20 x 85 cm, z warstwą chłonną 50x100cm i organizatorami przewodów
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Gramatura serwet 2 warstwowych 60g/m² + łata chłonna 80g/m². Odporność na penetrację płynów 165cm H₂O.

Reszta zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 57: Dotyczy zadania XXI. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 4 ręczniki do rąk 30,5x34cm
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
- 1 elastyczna pończocha 22 x 75 cm
- 1 serweta (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta) do artroskopii z torebką na płyny 230 x 320 cm (torba na płyny trójkątna o wymiarach 105x90cm) i z 2 elastycznymi otworami o średnicy 5cm + filtr i port do odsysania
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)




Gramatura serwet 3 warstwowych 75g/m². Odporność na penetrację płynów 167cm H₂O.
Reszta zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 58: Dotyczy zadania XXII. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia w rozmiarach: M-125cm, L-135cm, XL-145cm. Prosimy również o potwierdzenie, iż oczekując wewnętrznego owinięcia fartucha Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha z dwoma ręcznikami.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 59: Dotyczy zadania XXII. Czy Zamawiający oczekuje podwójnego oznakowania fartuchów, tj.

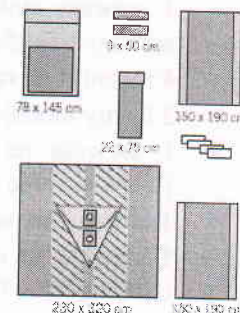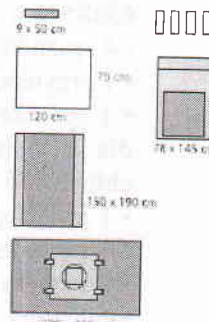

w formie literowej np. XL i centymetrowej, np. 145cm oraz podobnie jak w przypadku obłożeń podwójnego opakowania karton typu dyspenser w karton transportowy?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 60: dotyczące Zadania nr V, poz. 1. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy używając określenia włóknina materiałowa miał na myśli włókninę polipropylenową.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 61: dotyczące Zadania nr IX. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego – wymagania standardowe wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność na przeniknięcie cieczy – min. 200 cm H₂O. Zestaw zgodny z normą PN EN 13795 : 2011. Skład:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki wzmocniona 140x190cm – owinięcie zestawu
- 1 czerwona osłona na stolik Mayo wzmocniona 80x145cm
- 1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm
- 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 170x180cm
- 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm
- taśma samoprzylepna 9x50cm
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 62: dotyczące Zadania nr XI, poz. 1, Zadanie nr XII, poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego wzmocnionego wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² (łączna gramatura w strefie wzmocnionej 132 g/m²), odporność na przeniknięcie cieczy (zg. z EN 20811) – min. 200 cm H₂O. Zestaw zgodny z normą PN EN 13795 : 2011

Skład :

- 1 serweta na stół instrumentariuszki wzmocniona 140x190cm – owinięcie zestawu
- 1 czerwona osłona na stolik Mayo wzmocniona 80x145cm
- 1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm wzmocniona na powierzchni 50x75cm
- 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 175x200cm wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm
- 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm wzmocnione na powierzchni min. 45x60cm
- taśma samoprzylepna 9x50cm, wykonana z włókniny typu spunlace
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Zewnętrzne opakowanie oznakowane znakiem CE, zawierające rysunek produktu, nazwę zestawu, ilość i rozmiar poszczególnych elementów. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 63: dotyczące Zadania nr XIII, poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do chirurgii biodra wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² (łączna gramatura w strefie wzmocnionej 132 g/m²), odporność na przeniknięcie cieczy (zg. z EN 20811) – min. 200 cm H₂O. Zestaw zgodny z normą PN EN 13795 : 2011

Skład :

- 1 serweta na stół instrumentariuszki wzmocniona 140x190cm – owinięcie zestawu
- 1 czerwona osłona na stolik Mayo wzmocniona 80x145cm
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o min. wym. 7x95cm, wzmocniona na powierzchni min. 150x160cm
- 1 nieprzylepna serweta 150x150cm,
- 1 nieprzylepna serweta 75x90cm,

- 1 serweta przylepna 180x300cm,
- 1 osłona na kończynę 35x120cm,
- 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką

Dodatkowo: Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Zewnętrzne opakowanie oznakowane znakiem CE, zawierające rysunek produktu, nazwę zestawu, ilość i rozmiar poszczególnych elementów. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 64: dotyczące Zadania nr XVII, poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji kończyny dolnej wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² (gramatura w strefie wzmocnionej 132 g/m²) i Odporność na przeniknięcie cieczy (zg. z EN 20811) – min. 200 cm H₂O. Zestaw zgodny z normą PN EN 13795 : 2011

Skład :

1 serweta na stół instrumentariuszki wzmocniona 140x190cm - owinięcie zestawu

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo wzmocniona 80x145cm

1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x320cm z elastometrycznym (samouszczelniającym się) owalnym otworem 5x7cm otoczonym wzmocnieniem na powierzchni 105x150cm oraz uchwytem do mocowania kabli i drenów 2,5x25cm

- 1 nieprzylepna serweta 150x150cm,
- 1 osłona na kończynę 25x80cm,
- 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm

2 ręczniki celulozowe 30x40cm

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Zewnętrzne opakowanie oznakowane znakiem CE, zawierające rysunek produktu, nazwę zestawu, ilość i rozmiar poszczególnych elementów. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 65: dotyczące Zadania nr XIX, poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cesarskiego cięcia wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² (gramatura w strefie wzmocnionej 132 g/m²) i Odporność na przeniknięcie cieczy (zg. z EN 20811) – min. 200 cm H₂O. Zestaw zgodny z normą PN EN 13795 : 2011

Skład :

1 serweta na stół instrumentariuszki wzmocniona 140x190cm – owinięcie zestawu

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo wzmocniona 80x145cm
- 1 serweta w kształcie T o wym. 200/250x315cm z przylepnym oknem o wym. 18x28x32cm otoczonym torbą do zbiórki płynów o min wym. 80x80cm, 2. zaworami i kształtownikiem,
- 1 serweta do owinięcia noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m² o wym. 90x100cm
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Zewnętrzne opakowanie oznakowane znakiem CE, zawierające rysunek produktu, nazwę zestawu, ilość i rozmiar poszczególnych elementów. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 66: dotyczące Zadania nr XXII, poz. 1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartucha, w którym wszystkie szwy, poza mankietami, wykonane są techniką ultradźwiękową, o wymiarach:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA	SZEROKOŚĆ FARTUCHA	DŁUGOŚĆ RĘKAWA
M	120cm	163cm	65cm
L	130cm	167cm	72cm
XL	140cm	171cm	80cm
XXL	150cm	175cm	86cm
XXXL	160cm	180cm	90cm
Tolerancja	+/- 2cm	+/- 2cm	+/- 1,5cm

Fartuch pakowany razem z 2 rękawkami 30 x 40 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 67: dotyczące Zadania nr XXIII, poz. 1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartucha z włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m², wzmacnianego wewnątrz z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego polietylenu i polipropylenu o gramaturze 40 g/m². Odporność na przeniknięcie cieczy w obszarze krytycznym – min. 215 cm H₂O, BI 6 (w obszarze krytycznym), o wymiarach:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA	SZEROKOŚĆ FARTUCHA	DŁUGOŚĆ RĘKAWA
M	120cm	163cm	65cm
L	130cm	167cm	72cm
XL	140cm	171cm	80cm
XXL	150cm	175cm	86cm
XXXL	160cm	180cm	90cm
Tolerancja	+/- 2cm	+/- 2cm	+/- 1,5cm

Fartuch pakowany razem z 2 rękawkami 30 x 40 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 68: dotyczące Zadania nr XXII, poz. 1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartucha z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m², w którym wszystkie szwy, poza mankietami, wykonane są techniką ultradźwiękową, o wymiarach:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA	SZEROKOŚĆ FARTUCHA	DŁUGOŚĆ RĘKAWA
M	120 cm	163 cm	60 cm
L	130 cm	167 cm	64 cm
XL	135 cm	171 cm	68 cm
XXL	145 cm	175 cm	72 cm
XXXL	155 cm	180 cm	76 cm
Tolerancja	+/- 2cm	+/- 2cm	+/- 2cm

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 69: dotyczące Zadania nr XXIII, poz. 1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartucha z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m², wzmocnianego wewnątrz z przodu i na ¼ rękawów laminatem mikroporowego polietyleny i polipropylenu o gramaturze 40 g/m². Odporność na przeniknięcie cieczy w obszarze krytycznym – min. 215 cm H₂O, BI 6 (w obszarze krytycznym), o wymiarach:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA	SZEROKOŚĆ FARTUCHA	DŁUGOŚĆ RĘKAWA
M	120cm	163cm	60cm
L	130cm	167cm	64cm
XL	135cm	171cm	68cm
XXL	145cm	175cm	72cm
XXXL	155cm	180cm	76cm
Tolerancja	+/- 2cm	+/- 2cm	+/- 2cm

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 70: Zadanie nr I poz. 1.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka z gumką, pakowanego w worek, a 100 szt?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 71: Zadanie nr I poz. 2.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka z trokami, pakowanego w worek a 100 szt?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 72: Zadanie nr VII poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania osłony na kończynę w rozmiarze 80x30cm z taśmą lepłą 50x9 o gramaturze min. 43 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 73: Zadanie nr IX poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3); każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i numerze serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta? Materiał o gramaturze min. 56 g/m² na całej powierzchni wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włókniny polipropylenowej i folii polipropylenowo-polietylenowej, o następującym składzie?

serweta z przylepcem	1	240x150
serweta z przylepcem	1	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	90x75
taśma medyczna	1	50x9
serweta na stół instrum.	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk	2	40x20

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 74: Zadanie nr X poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 150x90cm?

Odpowiedź: zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 75: Zadanie nr X poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 200x180cm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 76: Zadanie nr X poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania obłożenia o gramaturze 74 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 77: Zadanie nr X poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni w rozmiarze 42x35cm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 78: Zadanie nr X poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy w rozmiarze 9x50cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 79: Zadanie nr X poz. 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 90x75cm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 80: Zadanie nr X poz. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 180x150cm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 81: Zadanie nr XI: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3); każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i numerze serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta? Materiał o gramaturze min. 56 g/m² na całej powierzchni wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włókniny polipropylenowej i folii polipropylenowo-polietylenowej, serwety z łatami chłonnymi w części wzmocnionej gramatura wynosi min. 110 g/m² i odporności na penetrację płynów min 450 cm H₂O. Całość pakowana w opakowanie typu blister, zestawy do transportu pakowane w karton zabezpieczający. Łata chłonna w wymiarach – 37,5x70cm. Skład zestawu:

Serweta na stół instrumentarium (owinięcie zestawu)	190x150cm	1
Serweta (głowa) z łatą chłonną i przylepcem 5x60cm	240x150cm	1
Serweta(stopa) z łatą chłonną i przylepcem 5x60cm	200x170cm	1
Serweta (boki) z łatą chłonną i przylepcem	90x75cm	2

5x90cm		
Taśma medyczna mocująca z włókniny BP	9x50cm	1
Ręczniczki włókninowe 40G 4W	10x20cm	2
Pokrowiec na stół Mayo	145x80cm	1

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 82: Zadanie nr XIII: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3); każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i numerze serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta? Materiał o gramaturze min. 56 g/m² na całej powierzchni wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włókniny polipropylenowej i folii polipropylenowo-polietylenowej, bez padów chłonnych, o następującym składzie?

serweta	1	260x240	WYCIĘC. U	100x20
serweta	1	240x150		
serweta	1	90x75		
serweta	3	250x160		
pokrowiec na nogę	1	120x37		
kieszon na płyny z kształtką	2	40x30		
taśma medyczna	7	50x9		
serweta na stół instrum.	1	190x150		
serweta na stół Mayo	1	145x80		
serwetki do rąk	2	40x20		

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 83: Zadanie nr XVI: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3); każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i numerze serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta? Materiał o gramaturze min. 56 g/m² na całej powierzchni wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włókniny polipropylenowej i folii polipropylenowo-polietylenowej, bez padów chłonnych, o następującym składzie?

	1	265x180	TRAPEZ	28X20x19
serweta	1	90x75		
taśma medyczna	1	50x9		
serweta na stół instrum.	1	190x150		
serweta na stół Mayo	1	145x80		
serwetki do rąk	2	40x20		

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 84: Zadanie nr XVII: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3); każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i numerze serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta? Materiał o gramaturze min. 73 g/m² na całej powierzchni wykonany z laminatu trzywarstwowego (włókniny polipropylenowej, włókniny wiskozowej i folii polipropylenowo-polietylenowej, bez padów chłonnych, o następującym składzie?

serweta z elementem elastycznym i otworem	1	300x240	OKRĄG	4
serweta na stół instrum.	1	190x150		
serweta na stolik Mayo	1	145x80		
serweta TF	1	200x150		
pokrowiec na kończynę	1	80x45		
taśma medyczna	2	50x9		
serwetki do rąk	4	40x20		

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 85: Zadanie nr XIX: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3); każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i numerze serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta? Materiał o gramaturze min. 73 g/m² na całej powierzchni wykonany z laminatu trzywarstwowego (włókniny polipropylenowej, włókniny wiskozowej i folii polipropylenowo-polietylenowej, bez padów chłonnych, o następującym składzie?

serweta T z workiem, folią chirurgiczną	1	325x250	PROST.
podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft	1	90x60	
serweta na stół instrum.	1	190x150	
serweta na stolik Mayo	1	145x80	
serwetki do rąk	4	40x20	

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 86: Zadanie nr XX: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3); każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i numerze serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta? Materiał o gramaturze min. 56 g/m² na całej powierzchni wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włókniny polipropylenowej i folii polipropylenowo-polietylenowej, bez padów chłonnych, o następującym składzie?

serweta z wycięciem U i przylepcem	1	240x200	WYCIĘC. U	60x7
serweta z przylepcem	1	240x150		
pokrowiec na kończynę górną pacjenta	1	75x37		
serweta pod kończynę górną pacjenta	1	180x150		
taśma medyczna	2	50x9		
serweta na stół instrum.	1	190x150		
serweta na stolik Mayo	1	145x80		
serwetki do rąk	2	40x20		

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 87: Zadanie nr XXI: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3); każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i numerze serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta? Materiał o gramaturze min. 56 g/m² na całej powierzchni wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włókniny polipropylenowej i folii polipropylenowo-polietylenowej, bez padów chłonnych, o następującym składzie?

serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów	1	320x240	OKRĄG	6
pokrowiec na nogę	1	75x37		
taśma medyczna	2	50x9		

serweta na stół instrum.	1	190x150		
serweta na stolik Mayo	1	145x80		
serwetki do rąk	2	40x20		

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 88: Zadanie nr XXII: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego fartucha chirurgicznego z włókniny typu SMS 35g/m² o specyfikacji: antystatyczny, I klasa palności wg 16 CFR 1610, rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm, wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo, oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu, opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy, fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie, rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 89: Zadanie nr XXIII: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego wzmocnionego fartucha chirurgicznego z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m² o specyfikacji: wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m², antystatyczny, I klasa palności wg 16 CFR 1610, w części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 36cm(M), min. 39cm(L), min. 41cm(XL), min. 42cm(XXL), wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha, rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm, wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo, oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu, opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy, fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie, rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200cmH₂O, mniej krytycznej min. 49cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie dla powierzchni krytycznych na sucho i mokro min. 98kPa.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 90: Zadanie nr XXIV: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu chirurgicznego wykonanego z włókniny polipropylenowej SMS w kolorach niebieskim i zielonym?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 91: Pytania dot. projektu umowy:

1. Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa będzie odbywać się w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: TAK

2. Czy Zamawiający może określić jaki procent umowy zostanie przez niego na pewno zrealizowany?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Z poważaniem

Z up. DYREKTORA

mgr Katarzyna Chmielewska-Borucka
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy